



Certificate number:

DG-04-F-0195


شماره گواهی:

Unit : bar

U.U.C Reading	Reference Reading		Error	
	Up	Down	Up	Down
0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	54.8	54.8	-4.8	-4.8
100	101.4	101.4	-1.4	-1.4
200	199.1	199.1	0.9	0.9
300	302.6	302.6	-2.6	-2.6
400	400.5	400.5	-0.5	-0.5

Zero Deviation	Nonlinearity	Hysteresis	$\pm$ Uncertainty	$\pm$ Permissible Error
0.0	4.8	0.0	2.83	6

Error Chart

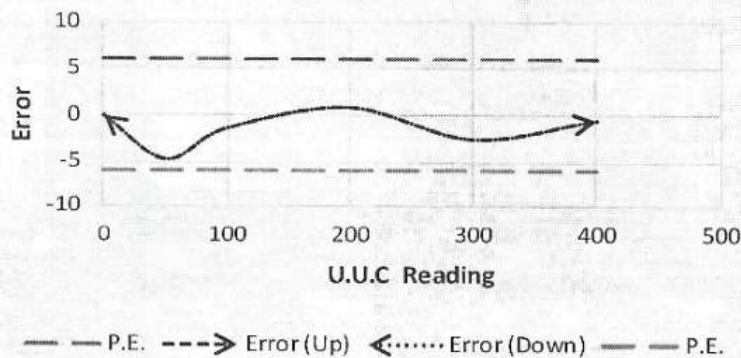

اعلام نتیجه :

• تجهیز فوق مورد تایید می باشد.



1. The user must act in order to recalibrate during a specified period of time.
2. This certificate shall not be published or reproduced other than IN FULL.
3. This certificate is not valid without special stamp of DGT laboratory.
4. This expanded Uncertainty of measurement with attention to coverage factor $k=2$ for normal distribution is providing level of approximately 95%

- ۱- استفاده کننده باید در فاصله زمانی معین اقدام به کالیبراسیون مجدد نماید.
- ۲- هرگونه نسخه برداری باید بطور کامل و از تمامی صفحات باشد.
- ۳- این گواهی بدون برپسب و مهر آزمایشگاه صادر کننده فاقد اعتبار است.
- ۴- عدم قطعیت مبسوط اندازه گیری با در نظر گرفتن ضریب پوشش $K=2$ برای توزیع نرمال با سطح اطمینان ۹۵٪ میباشد.



Certificate of Calibration

Certificate number:

DG-04-F-0195

شماره گواهی:

Customer:

نام متقاضی: شرکت دانا سیال نوین

Address:

آدرس: تهران-شهرک صنعتی پرد-خیابان گلزار-گلگشت-پلاک ۹

Require:

تاریخ درخواست: ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

Cal. Date:

تاریخ کالیبراسیون: ۱۴۰۴/۰۱/۲۵

Due Date:

تاریخ انقضاء: ۱۴۰۶/۰۱/۲۵

Date Of Issue:

تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

Calibrated Instrument Description

مشخصات دستگاه کالیبره شده:

Nomenclature:

نام دستگاه: فشارسنج عقربه ای

Model:

مدل دستگاه: 1.5

Range/Resolution:

گستره/تفکیک پذیری: 10 bar / 0~400 bar

Serial/ID:

سریال/شماره شناسایی دستگاه: DSN-003

Manufacturer:

سازنده: HANGZHOU

Calibration Report

گزارش کالیبراسیون:

Reference & Traceability:

استانداردهای اندازه گیری مرجع و قابلیت ردیابی:

- Pressure Test Gauge (1000 bar)

Serial No: 0109, Traceable to: National & International Standard Levels.

Environmental Condition:

شرایط محیطی:

Air Condition has been carried out within the range below:

شرایط محیطی مطابق با استاندارد مرجع جهت کالیبراسیون تجهیزات فشار

Temp. 22±3°C, Humidity 35-60%

دما 22±3°C و رطوبت 35-60%

Calibration Method:

روش کالیبراسیون:

کالیبراسیون تجهیز توسط استاندارد مرجع براساس استاندارد IDS-GDL-340 همپلین مطابق دستورالعمل کالیبراسیون به شماره شناسایی T-W-CP-01.

Calibration Result

نتایج کالیبراسیون:

According To The Attached Table

کلیه اطلاعات و نتایج کالیبراسیون مطابق جدول پیوست میباشند.

امضا مدیر آزمایشگاه



انجام دهنده

۱- استفاده کننده باید در فاصله زمانی معین اقدام به کالیبراسیون مجدد نماید.

۲- هرگونه نسخه برداری باید بطور کامل و از تمامی صفحات باشد.

۳- این گواهی بدون برچسب و مهر آزمایشگاه صادر کننده فاقد اعتبار است.

۴- عدم قطعیت میسوسا اندازه گیری با در نظر گرفتن ضریب پوشش K=2

برای توزیع نرمال با سطح اطمینان ۹۵٪ میباشد.

1. The user must act in order to recalibrate during a specified period of time.
2. This certificate shall not be published or reproduced other than IN FULL.
3. This certificate is not valid without special stamp of DGT laboratory.
4. This expanded Uncertainty of measurement with attention to coverage factor k=2 for normal distribution is providing level of approximately 95%

Form NO: T-F-104-01

