




Unit : bar

U.U.C Reading	Reference Reading		Error	
	Up	Down	Up	Down
0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	48.4	48.4	1.6	1.6
100	99.1	99.1	0.9	0.9
150	148.6	148.6	1.4	1.4
200	197.3	197.3	2.7	2.7
250	247.0	247.0	3.0	3.0

Zero Deviation	Nonlinearity	Hysteresis	± Uncertainty
0.0	3.0	0.0	1.83

Error Chart

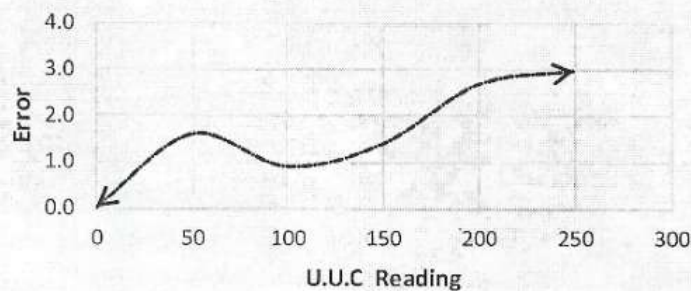

---> Error (Up) <----- Error (Down)

اعلام نتیجه :

• تجهیز فوق مورد تایید می باشد.



1. The user must act in order to recalibrate during a specified period of time.
2. This certificate shall not be published or reproduced other than IN FULL.
3. This certificate is not valid without special stamp of DGT laboratory.
4. This expanded Uncertainty of measurement with attention to coverage factor $k=2$ for normal distribution is providing level of approximately 95%

- ۱- استفاده کننده باید در فاصله زمانی معین اقدام به کالیبراسیون مجدد نماید.
- ۲- هرگونه نسخه برداری باید بطور کامل و از تمامی صفحات باشد.
- ۳- این گواهی بدون برچسب و مهر آزمایشگاه صادر کننده فاقد اعتبار است.
- ۴- عدم قطعیت مبسوط اندازه گیری با در نظر گرفتن ضریب پوشش $K=2$ برای توزیع نرمال با سطح اطمینان ۹۵٪ میباشد.



Certificate of Calibration

Certificate number:

DG-04-F-0198

شماره گواهی:

Customer:

نام متقاضی: شرکت دانا سیال نوین

Address:

آدرس: تهران-شهرک صنعتی پرد-فیابان گلزار-گلگشت-پلاک ۹

Require:

تاریخ درخواست: ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

Cal. Date:

تاریخ کالیبراسیون: ۱۴۰۴/۰۱/۲۵

Due Date:

تاریخ انقضاء: ۱۴۰۶/۰۱/۲۵

Date Of Issue:

تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

Calibrated Instrument Description

مشخصات دستگاه کالیبره شده:

Nomenclature:

نام دستگاه: فشارسنج عقربه ای

Model:

مدل دستگاه: ---

Range/Resolution:

گستره/تفکیک پذیری: 5 bar / 0-250 bar

Serial/ID:

سریال/شماره شناسایی دستگاه: DSN-001

Manufacturer:

سازنده: ---

Calibration Report

گزارش کالیبراسیون:

Reference & Traceability:

استانداردهای اندازه گیری مرجع و قابلیت رد یابی:

- Pressure Test Gauge (1000 bar)

Serial No: 0109, Traceable to: National & International Standard Levels.

Environmental Condition:

شرایط محیطی:

Air Condition has been carried out within the range below:

شرایط محیطی مطابق با استاندارد مرجع مهت کالیبراسیون تمهیزات فشار

Temp. $22 \pm 3^\circ\text{C}$, Humidity 35-60%

دما $22 \pm 3^\circ\text{C}$ و رطوبت 35-60%

Calibration Method:

روش کالیبراسیون:

کالیبراسیون تمهیز توسط استاندارد مرجع براساس استاندارد IDS-GDL-340 همپین مطابق دستورالعمل کالیبراسیون به شماره شناسایی T-W-CP-01.

Calibration Result

نتایج کالیبراسیون:

According To The Attached Table

کلیه اطلاعات و نتایج کالیبراسیون مطابق جدول پیوست میباشد.

امضا مدیر آزمایشگاه



انجام دهنده

1. The user must act in order to recalibrate during a specified period of time.
2. This certificate shall not be published or reproduced other than IN FULL.
3. This certificate is not valid without special stamp of DGT laboratory.
4. This expanded Uncertainty of measurement with attention to coverage factor $k=2$ for normal distribution is providing level of approximately 95%

Form NO: T-F-104-01

